



CERALOG[®]
SYSTEM

IMPLANTATPASS

a perfect fit™

camlog

CERALOG® –
KERAMIKIMPLANTATE VON CAMLOG:
UNSIHTBAR – WEISS – BIOKOMPATIBEL – METALLFREI. EINE SINNVOLLE
ALTERNATIVE FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT.



PERSÖNLICHE ANGABEN

.....
Nachname

.....
Vorname

.....
Straße /Nr.

.....
PLZ

.....
Ort

.....
Geburtsdatum

.....
Krankenversicherung

Liebe Patientin, lieber Patient,

dieser Implantatpass dokumentiert, dass Sie hochwertige Zahnimplantate von CAMLOG erhalten haben. Bitte bewahren Sie ihn auf und bringen Sie ihn zur Implantatbehandlung mit.


Mit freundlichen Grüßen
Ihr Praxisteam

Eine Implantattherapie dient der Verbesserung der Mundgesundheit und der Steigerung der Lebensqualität. Damit Sie lange Freude an Ihrer Implantatversorgung haben, geben wir Ihnen fünf allgemeine Pflege- und Verhaltenshinweise. Ihr Zahnarzt und Ihr Praxisteam werden Sie speziell aufklären und Ihre Fragen gerne beantworten.

1

DIREKT NACH DER OPERATION:

- Das Operationsgebiet äußerlich kühlen.
- Anstrengungen, z. B. schweres Heben oder Sport, vermeiden.
- Nicht Rauchen!
- Keinen Kaffee, Schwarztee, Alkohol oder Cola trinken.
- Erst wenn Sie wieder volles Gefühl im Operationsgebiet haben, können Sie weiche Nahrung zu sich nehmen.

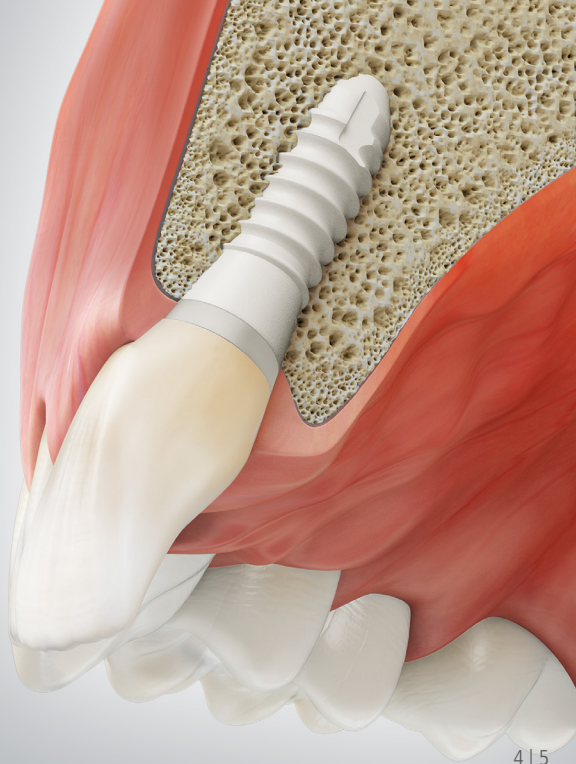



2

DIE ERSTE WOCHE NACH DER IMPLANTATION:

- Körperliche Anstrengungen vermeiden.
- Kauen Sie nicht im Implantatbereich.
- Nach jeder Nahrungsaufnahme den Mund vorsichtig mit lauwarmem Wasser ausspülen.
- Putzen Sie Ihre Zähne regelmäßig, sparen Sie aber den Implantatbereich aus.
- Benutzen Sie keine Munddusche oder elektrische Zahnbürste im Operationsgebiet.
- Bei Schmerzen, insbesondere klopfender Art, sollten Sie sofort Ihren Zahnarzt aufsuchen.
- Fragen Sie Ihren Zahnarzt zur Verwendung antibakterieller Mundspüllösungen.

3

NACH DER NAHTENTFERNUNG:

- Lassen Sie das Implantat völlig in Ruhe einheilen (nicht mit der Zunge oder den Fingern berühren).
- Putzen Sie den Bereich um das Implantat so, wie es Ihnen Ihr Praxisteam gezeigt hat.

4

NACH DER FREILEGUNG DES IMPLANTATS:


- Beachten Sie die gleichen Vorkehrungen wie in der ersten Woche nach der Implantation (Punkt 2).

5

NACH DER PROTHETISCHEN VERSORGUNG DER IMPLANTATE:

- Implantate erfordern eine konsequente Mundhygiene, damit sie langfristig und erfolgreich ihre Funktion erfüllen können.
- Beachten Sie die Mundhygiene-Instruktionen Ihres Zahnarztes und nutzen Sie die Möglichkeit der professionellen Zahnreinigung (PZR).
- Lassen Sie Zähne und Implantate regelmäßig überprüfen. Ihr Zahnarzt wird Sie über das Kontrollprogramm informieren.

IN DIESEN REGIONEN WURDEN IHRE CERALOG® IMPLANTATE EINGESETZT:

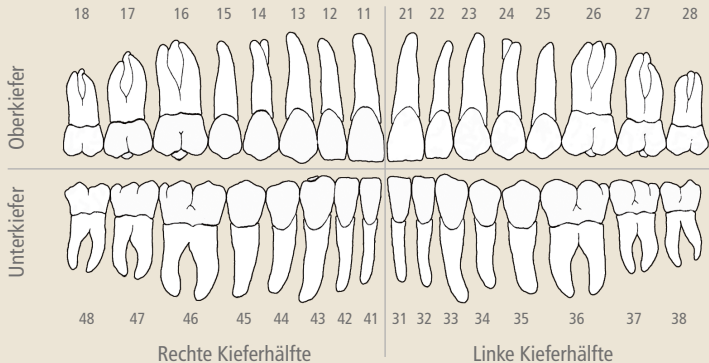

CHIRURGIE mit einem original CERALOG® Implantat von CAMLOG

Region

Implantattyp

Implantationsdatum

Implantatdurchmesser

Implantatlänge

LOT (Chargen-Nr.)

Freilegungsdatum

AUFKLEBER

Praxisstempel

PROTHETIK von CAMLOG

Aufbau (Typ)

LOT (Chargen-Nr.)

Eingliederungsdatum

Suprastruktur:

verschraubt zementiert abnehmbar

Befestigungsmaterial

.....

AUFKLEBER

Praxisstempel

BIOMATERIAL von BioHorizons/CAMLOG

Produktname

.....

Region

.....

Datum

.....

REF

.....

LOT (Chargen-Nr.)

.....

Manufacturer

.....

AUFKLEBER

Praxisstempel

MEMBRAN von BioHorizons/CAMLOG

Produktname

.....

Region

.....

Datum

.....

REF

.....

LOT (Chargen-Nr.)

.....

Manufacturer

.....

AUFKLEBER

Praxisstempel

CHIRURGIE mit einem original CERALOG® Implantat von CAMLOG

Region

Implantattyp

Implantationsdatum

Implantatdurchmesser

Implantatlänge

LOT (Chargen-Nr.)

Freilegungsdatum

AUFKLEBER

Praxisstempel

PROTHETIK von CAMLOG

Aufbau (Typ)

LOT (Chargen-Nr.)

Eingliederungsdatum

Suprastruktur:

verschraubt

zementiert

abnehmbar

Befestigungsmaterial

AUFKLEBER

Praxisstempel

BIOMATERIAL von BioHorizons/CAMLOG

Produktname

Region

Datum

REF

LOT (Chargen-Nr.)

Manufacturer

AUFKLEBER

Praxisstempel

MEMBRAN von BioHorizons/CAMLOG

Produktname

Region

Datum

REF

LOT (Chargen-Nr.)

Manufacturer

AUFKLEBER

Praxisstempel

CHIRURGIE mit einem original CERALOG® Implantat von CAMLOG

Region

Implantattyp

Implantationsdatum

Implantatdurchmesser

Implantatlänge

LOT (Chargen-Nr.)

Freilegungsdatum

AUFKLEBER

Praxisstempel

PROTHETIK von CAMLOG

Aufbau (Typ)

LOT (Chargen-Nr.)

Eingliederungsdatum

Suprastruktur:

verschraubt zementiert abnehmbar

Befestigungsmaterial

.....

AUFKLEBER

Praxisstempel

BIOMATERIAL von BioHorizons/CAMLOG

Produktname

Region

Datum

REF

LOT (Chargen-Nr.)

Manufacturer

AUFKLEBER

Praxisstempel

MEMBRAN von BioHorizons/CAMLOG

Produktname

Region

Datum

REF

LOT (Chargen-Nr.)

Manufacturer

AUFKLEBER

Praxisstempel

CHIRURGIE mit einem original CERALOG® Implantat von CAMLOG

Region

Implantattyp

Implantationsdatum

Implantatdurchmesser

Implantatlänge

LOT (Chargen-Nr.)

Freilegungsdatum

AUFKLEBER

Praxisstempel

PROTHETIK von CAMLOG

Aufbau (Typ)

LOT (Chargen-Nr.)

Eingliederungsdatum

Suprastruktur:

verschraubt zementiert abnehmbar

Befestigungsmaterial

.....

AUFKLEBER

Praxisstempel

BIOMATERIAL von BioHorizons/CAMLOG

Produktname

Region

Datum

REF

LOT (Chargen-Nr.)

Manufacturer

AUFKLEBER

Praxisstempel

MEMBRAN von BioHorizons/CAMLOG

Produktname

Region

Datum

REF

LOT (Chargen-Nr.)

Manufacturer

AUFKLEBER

Praxisstempel

CHIRURGIE mit einem original CERALOG® Implantat von CAMLOG

Region

Implantattyp

Implantationsdatum

Implantatdurchmesser

Implantatlänge

LOT (Chargen-Nr.)

Freilegungsdatum

AUFKLEBER

Praxisstempel

PROTHETIK von CAMLOG

Aufbau (Typ)

LOT (Chargen-Nr.)

Eingliederungsdatum

Suprastruktur:

verschraubt zementiert abnehmbar

Befestigungsmaterial

.....

AUFKLEBER

Praxisstempel

BIOMATERIAL von BioHorizons/CAMLOG

Produktname

.....

Region

.....

Datum

.....

REF

.....

LOT (Chargen-Nr.)

.....

Manufacturer

.....

AUFKLEBER

Praxisstempel

MEMBRAN von BioHorizons/CAMLOG

Produktname

.....

Region

.....

Datum

.....

REF

.....

LOT (Chargen-Nr.)

.....

Manufacturer

.....

AUFKLEBER

Praxisstempel

CHIRURGIE mit einem original CERALOG® Implantat von CAMLOG

Region

Implantattyp

Implantationsdatum

Implantatdurchmesser

Implantatlänge

LOT (Chargen-Nr.)

Freilegungsdatum

AUFKLEBER

Praxisstempel

PROTHETIK von CAMLOG

Aufbau (Typ)

LOT (Chargen-Nr.)

Eingliederungsdatum

Suprastruktur:

verschraubt zementiert abnehmbar

Befestigungsmaterial

AUFKLEBER

Praxisstempel

BIOMATERIAL von BioHorizons/CAMLOG

Produktname

Region

Datum

REF

LOT (Chargen-Nr.)

Manufacturer

AUFKLEBER

Praxisstempel

MEMBRAN von BioHorizons/CAMLOG

Produktname

Region

Datum

REF

LOT (Chargen-Nr.)

Manufacturer

AUFKLEBER

Praxisstempel

CHIRURGIE mit einem original CERALOG® Implantat von CAMLOG

Region

Implantattyp

Implantationsdatum

Implantatdurchmesser

Implantatlänge

LOT (Chargen-Nr.)

Freilegungsdatum

AUFKLEBER

Praxisstempel

PROTHETIK von CAMLOG

Aufbau (Typ)

LOT (Chargen-Nr.)

Eingliederungsdatum

Suprastruktur:

verschraubt zementiert abnehmbar

Befestigungsmaterial

AUFKLEBER

Praxisstempel

BIOMATERIAL von BioHorizons/CAMLOG

Produktname

Region

Datum

REF

LOT (Chargen-Nr.)

Manufacturer

AUFKLEBER

Praxisstempel

MEMBRAN von BioHorizons/CAMLOG

Produktname

Region

Datum

REF

LOT (Chargen-Nr.)

Manufacturer

AUFKLEBER

Praxisstempel

MEHR INFORMATIONEN ÜBER ZAHNIMPLANTATE UND CAMLOG FINDEN SIE AUF UNSERER PATIENTENWEBSEITE



patienten.camlog.de

Deutschland

CAMLOG Vertriebs GmbH
Maybachstraße 5
D-71299 Wimsheim
info.de@camlog.com
www.camlog.de

Headquarters

CAMLOG Biotechnologies AG
Margarethenstrasse 38
CH-4053 Basel

camlog